

**15 GIUGNO 2023**  
**ore 15.00 - 19.15**

**WEBINAR**  
**GRUPPO 1 LIVELLO**

# **I CONTROLLI DI QUALITÀ NELLO SCREENING: CITOLOGIA E HPV**



**ESPERIENZE DI GESTIONE DEL  
CONTROLLO DI QUALITÀ NELLE  
REGIONI CON CENTRALIZZAZIONE  
HPV E CITOLOGIA**



**L'ESPERIENZA DELLA REGIONE VENETO**

**SILVIA GORI - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS -  
PADOVA**


***La sottoscritta Gori Silvia***

*ai sensi dell'art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell'Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009,*

dichiara


*che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario*

## 2015 passaggio a HPV test primario (30-64 anni)




Costo 4,95€ a test

## SANTORSO – citologia di triage

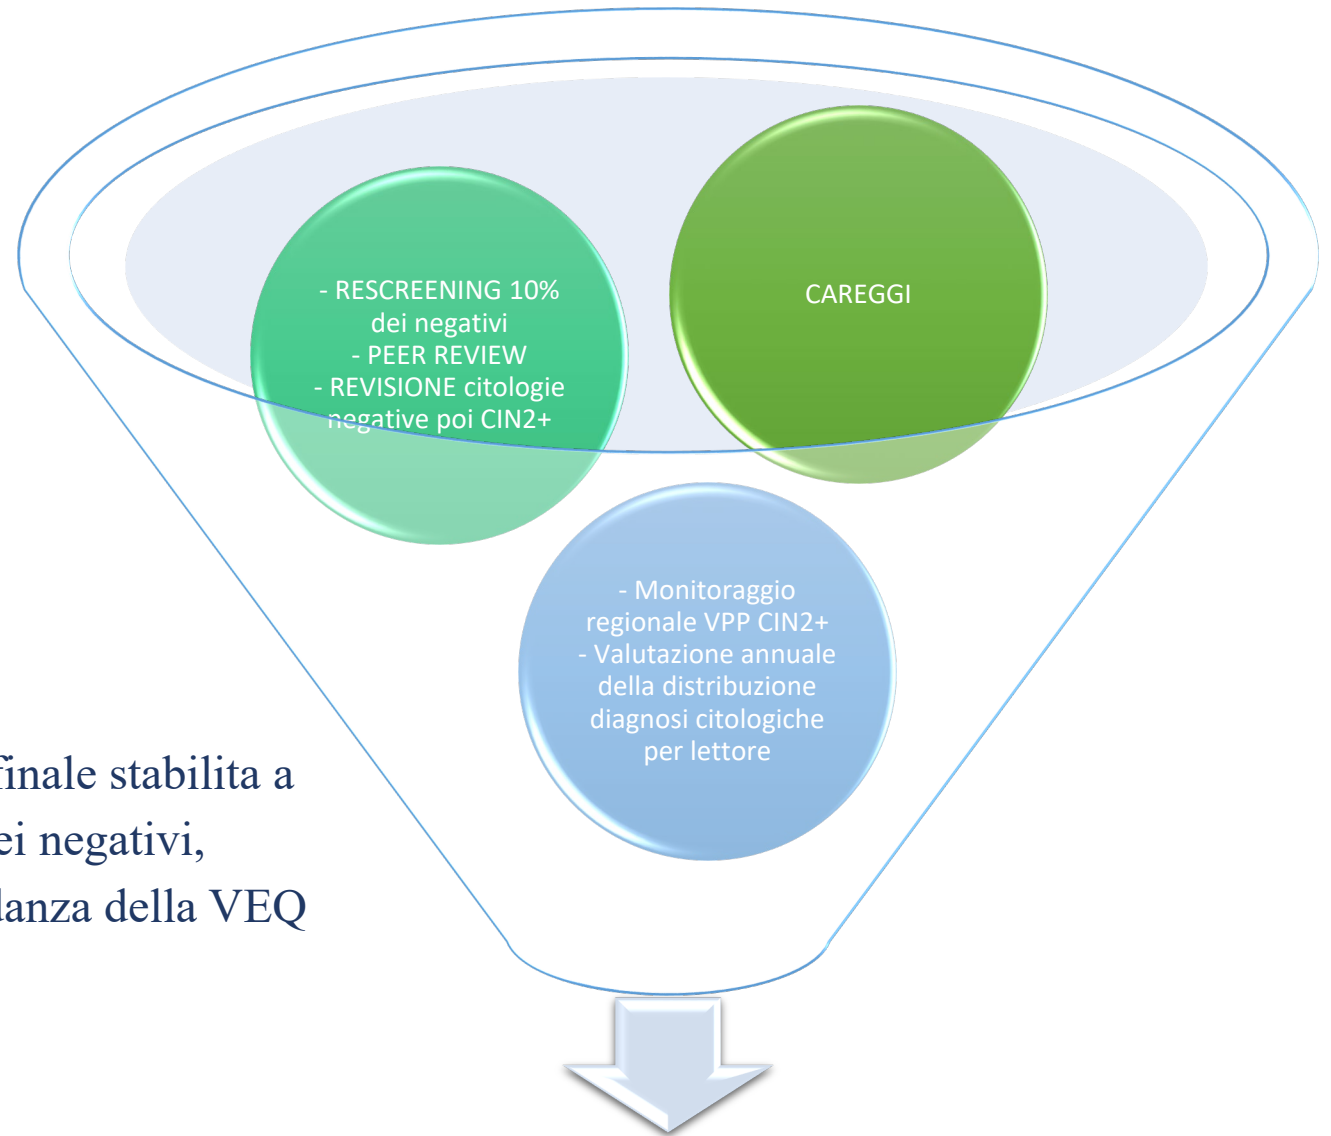

Se discordanza in peer review, interpretazione finale stabilita a maggioranza. Se discordanza nel rescreening dei negativi, controllo più marcato di chi ha letto. Se discordanza della VEQ discussione del team

## Controlli di qualità

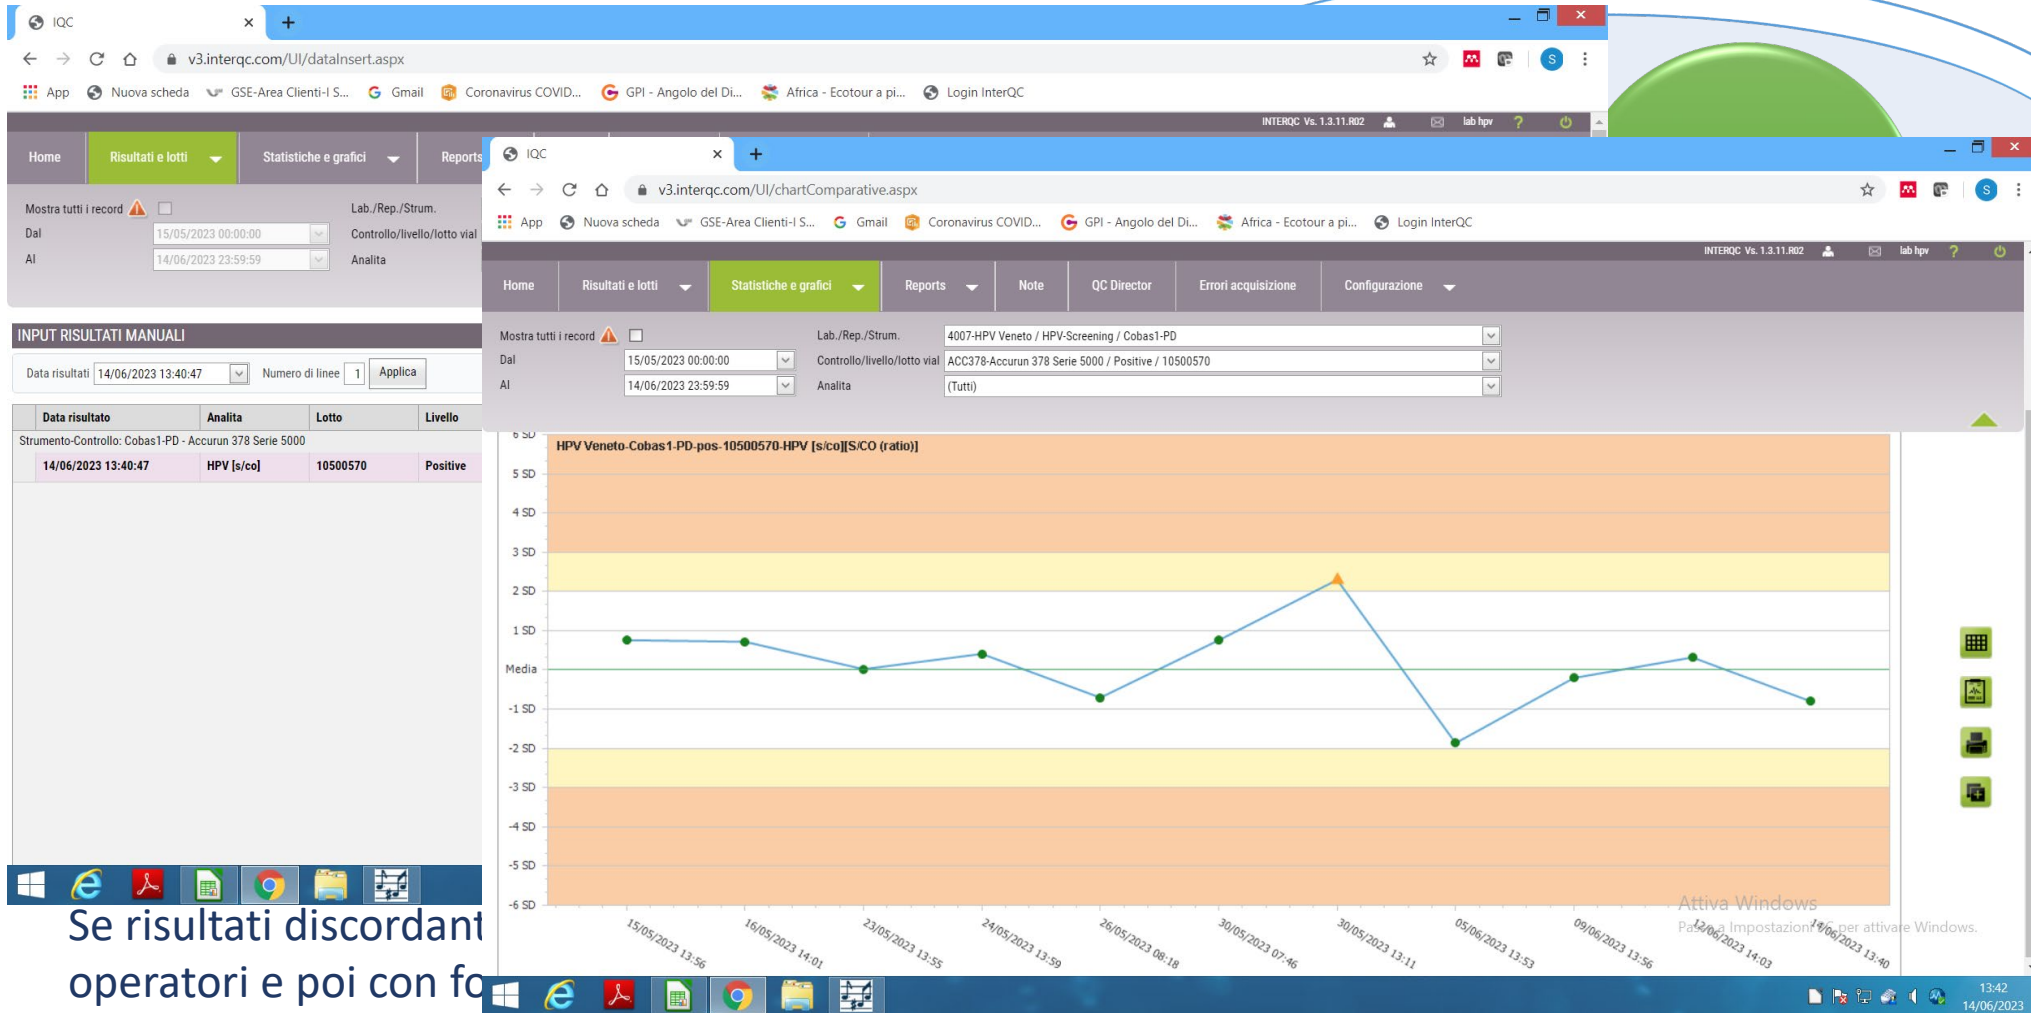


Se risultati discordanti operatori e poi con fo

# Controlli di qualità

$\mu$   
σ

## VERONA – HPV primario

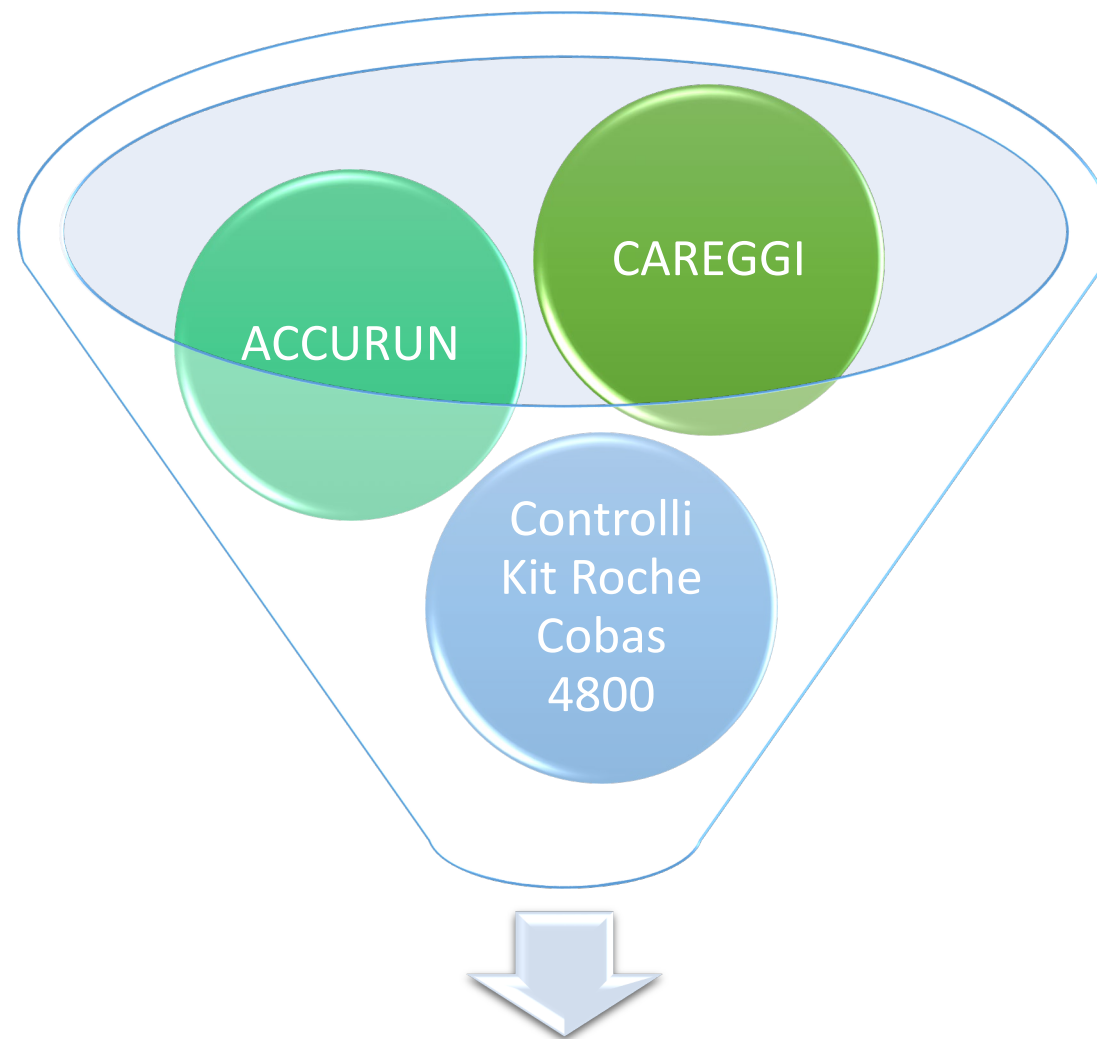



Se risultati discordanti confronto tra operatori e poi con fornitore

## Controlli di qualità

## PADOVA – HPV primario

### Azioni correttive:

- Risultato contrario all'atteso (positivo anziché negativo, o viceversa): **ripetizione della seduta**;
- Risultato corretto ma con valore Ct oltre la 3<sup>a</sup> deviazione standard (+3DS): verifica dei Ct dei controlli della piastra, verifica dell'andamento dei Ct del controllo interno nelle sedute precedenti (scostamento graduale o brusco?), e verifica della distribuzione dei risultati fra i campioni (% di positivi e valori Ct): (A) **ripetizione della seduta** nel caso di rischio di falsi positivi; (B) **sostituzione** di quel controllo interno nel caso di inadeguatezza dello stesso;
- Risultato corretto ma con valore Ct sotto la 3<sup>a</sup> deviazione standard (-3DS): **ripetizione dei campioni positivi**

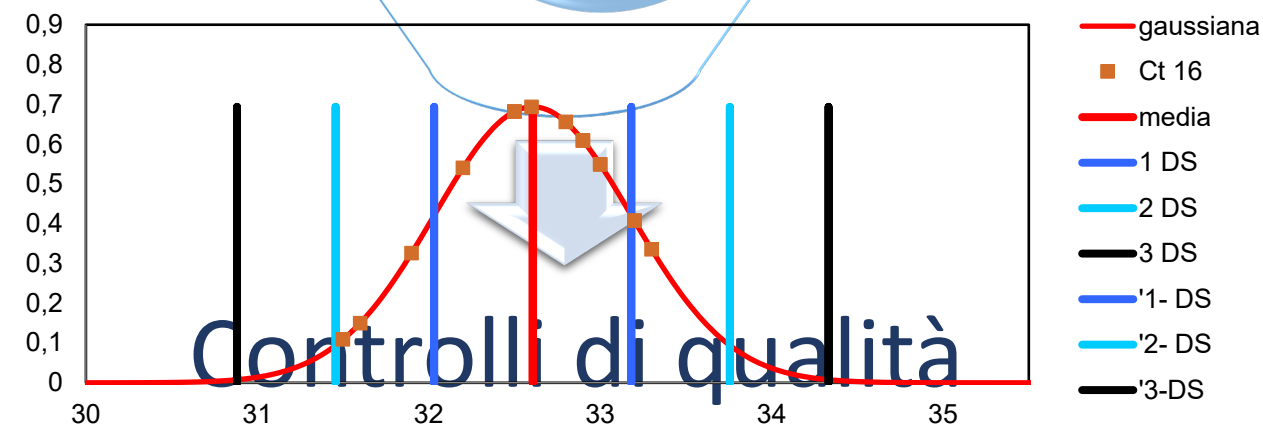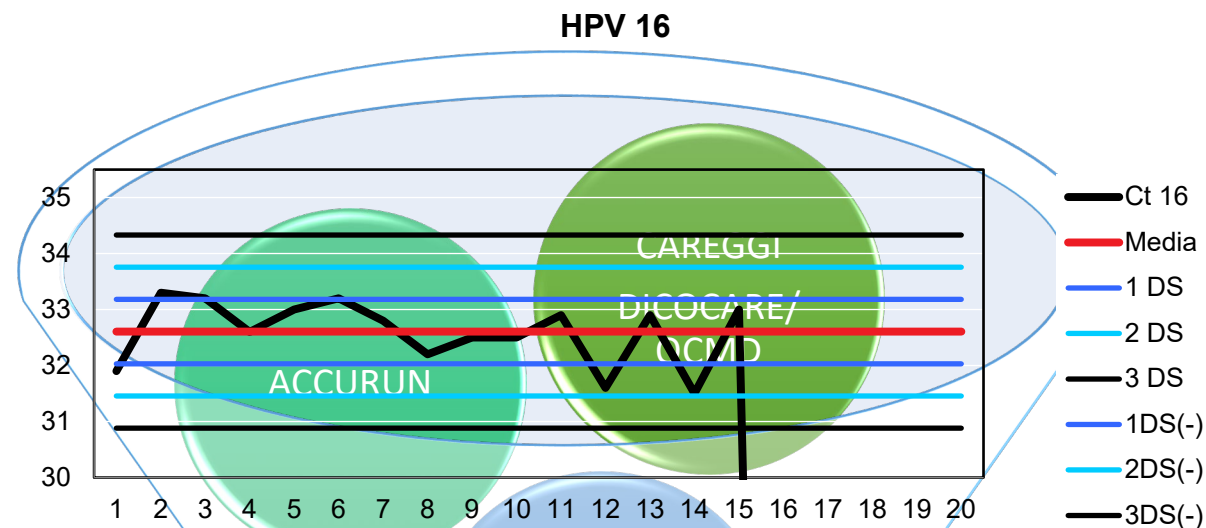

# CONTROLLI DI QUALITÀ

## **Interlaboratorio**

Set di 4 campioni, le aliquote vengono testate in ogni laboratorio

Verifica dei risultati qualitativi e dei valori di ct



## Differenze

CQI

Registrazione

Azioni  
correttive

## Somiglianze

VEQ  
CAREGGI

ACCURUN

15 GIUGNO 2023  
ore 15.00 - 19.15

WEBINAR  
GRUPPO 1 LIVELLO

# I CONTROLLI DI QUALITÀ NELLO SCREENING: CITOLOGIA E HPV



Grazie a....

Romano Colombari  
Giovanna Gallina  
Barbara Pertoldi  
Annarosa Del Mistro  
Helena Frayle

....e a voi per l'attenzione!